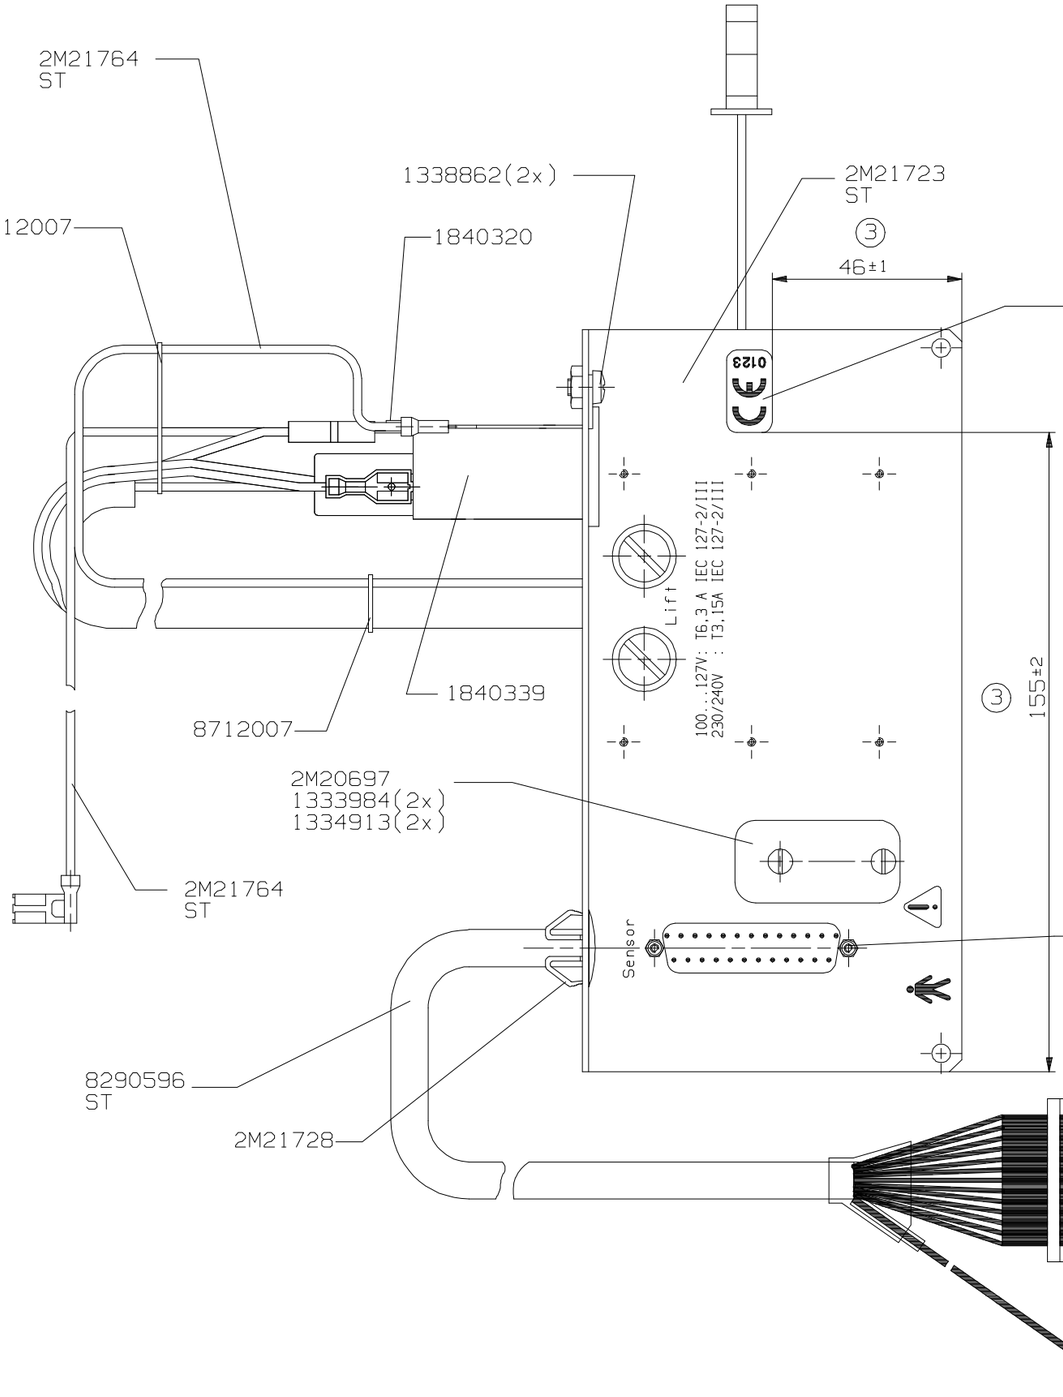

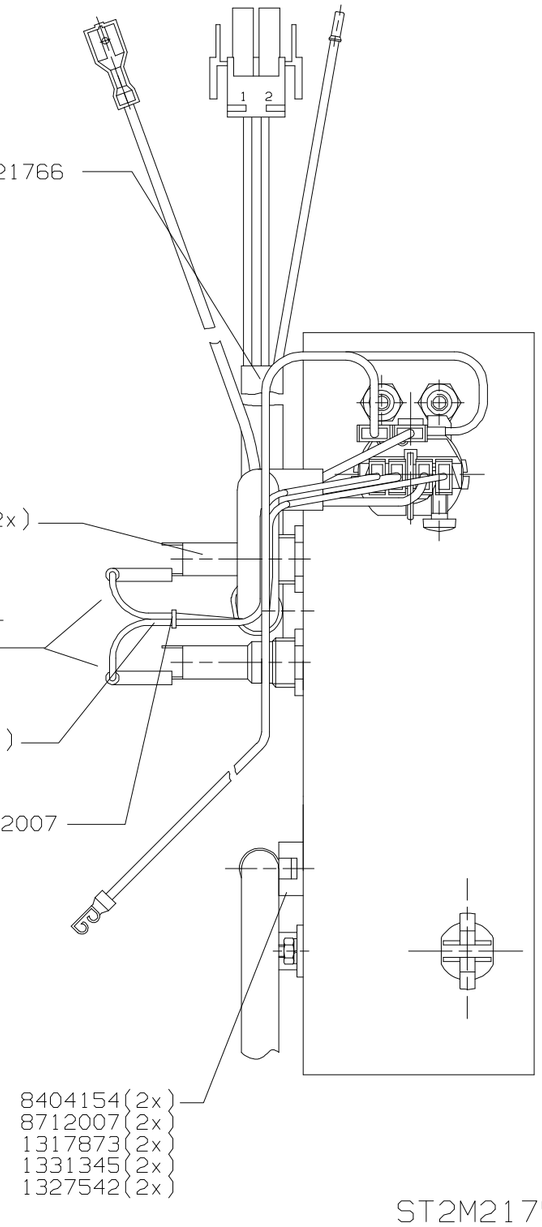

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without our permission, if not released.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind. 200x180 DWN 1210:

2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Kappe	2M20356
2 Stck	Kabelbinder	8712007

ST2M21756

scale: 1:1	general tolerances: ---	material: ---	safety class: <s> 0, <m> 0	
field reserved	revision text: Schild und Masze nachgetragen (1998/CC/135)			
filing dept.: 2530	responsible dept.: 3401		author	approved
		date	27.04.1998	27.04.1998
		name	Stickel	Hartwig
contract: n				
type: drawing	language: de	title: Netzanschlusz IC		
	replacement for: 2M21756-02	number: 2M21756		
creating system: CADRA	release status: PROD	revision index: 03	occures: 03	page/of: 01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A2

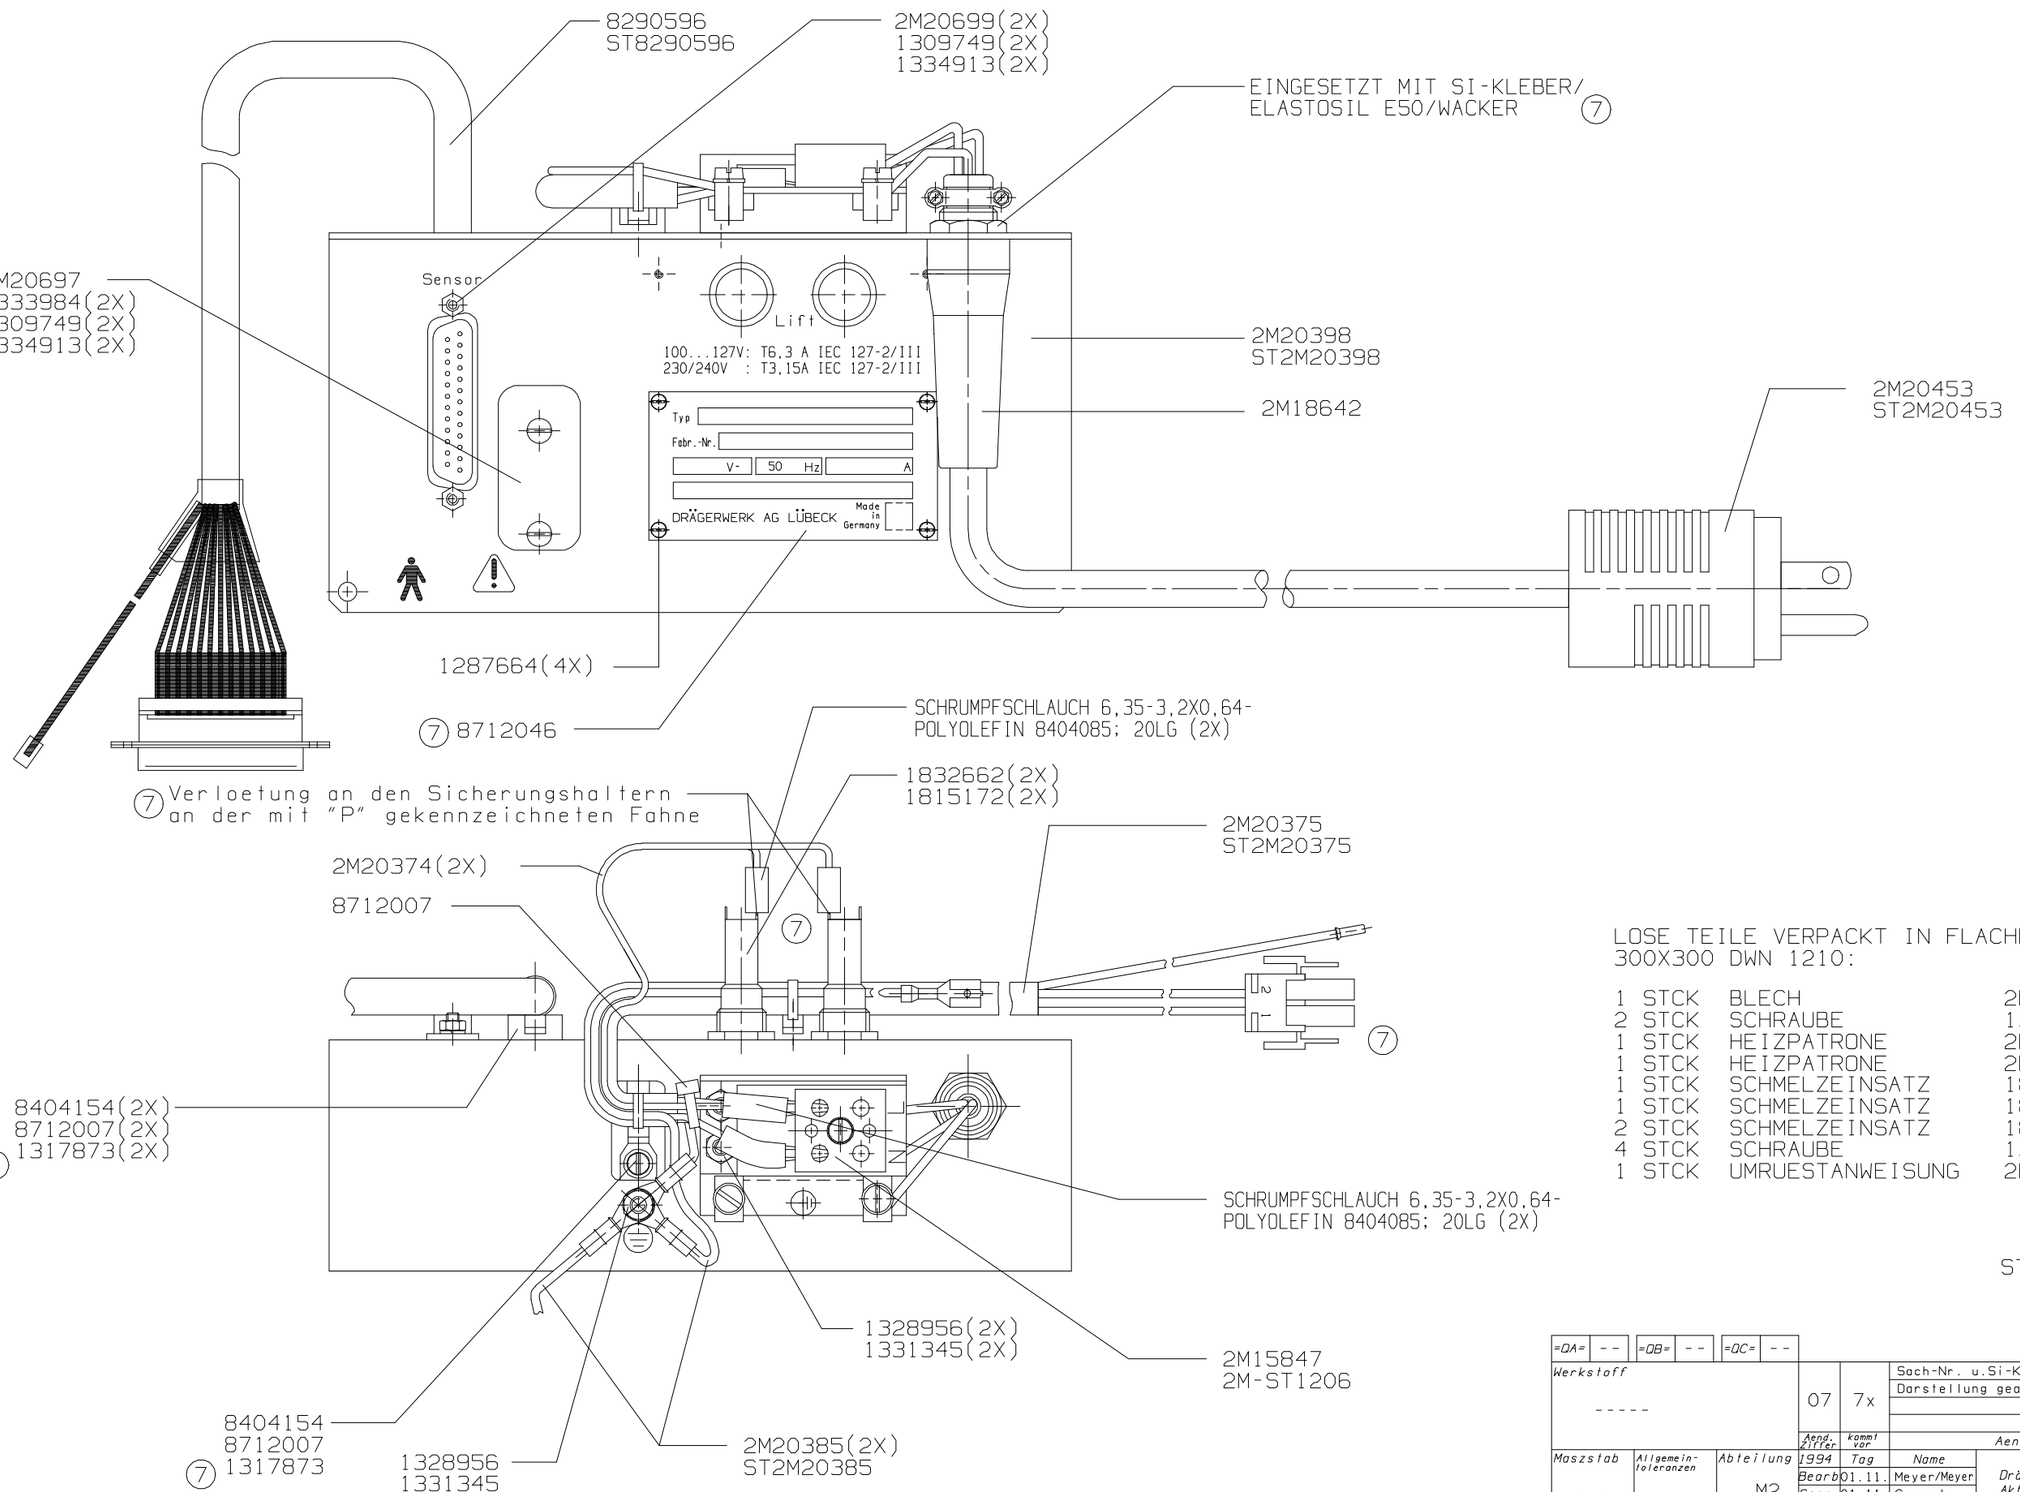

LOSE TEILE VERPACKT IN FLACHBEUTEL MIND. 300X300 DWN 1210:

1	STCK	BLECH	2M20461, ST2M20461
2	STCK	SCHRAUBE	1338382
1	STCK	HEIZPATRONE	2M20328
1	STCK	HEIZPATRONE	2M20331
1	STCK	SCHMELZEINSATZ	1814974
1	STCK	SCHMELZEINSATZ	1815083
2	STCK	SCHMELZEINSATZ	1815172
4	STCK	SCHRAUBE	1338072
1	STCK	UMRUESTANWEISUNG	2M20555

ST2M20425

=QA= -- =QB= -- =QC= --

Werkstoff: -----

07 | 7x

Sach-Nr. u.Si-Kleber geaendert:Sach-Nr. entfallen:
Darstellung geaendert: Text neu
(33/94)

Aend. Ziffer | kommt vor | Aenderungen

Maszstab: 1:1 | Allgemeintoleranzen: --- | Abteilung: M2

	1994	Tag	Name
Bearb		01.11.	Meyer/Meyer
Gepr.		01.11.	Conrad
		--	--

Drägerwerk Aktiengesellschaft

Dräger

PROD | CADRA=8

Benennung: Netzanschlusz 8000 IC (120V)

Zeichnungs-Nr.: 2M20425

Ersatz fuer 2M20425-06

Ersetzt durch

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden,
without express author ity. All rights reserved.
© DRÄGERWERK AG Lübeck

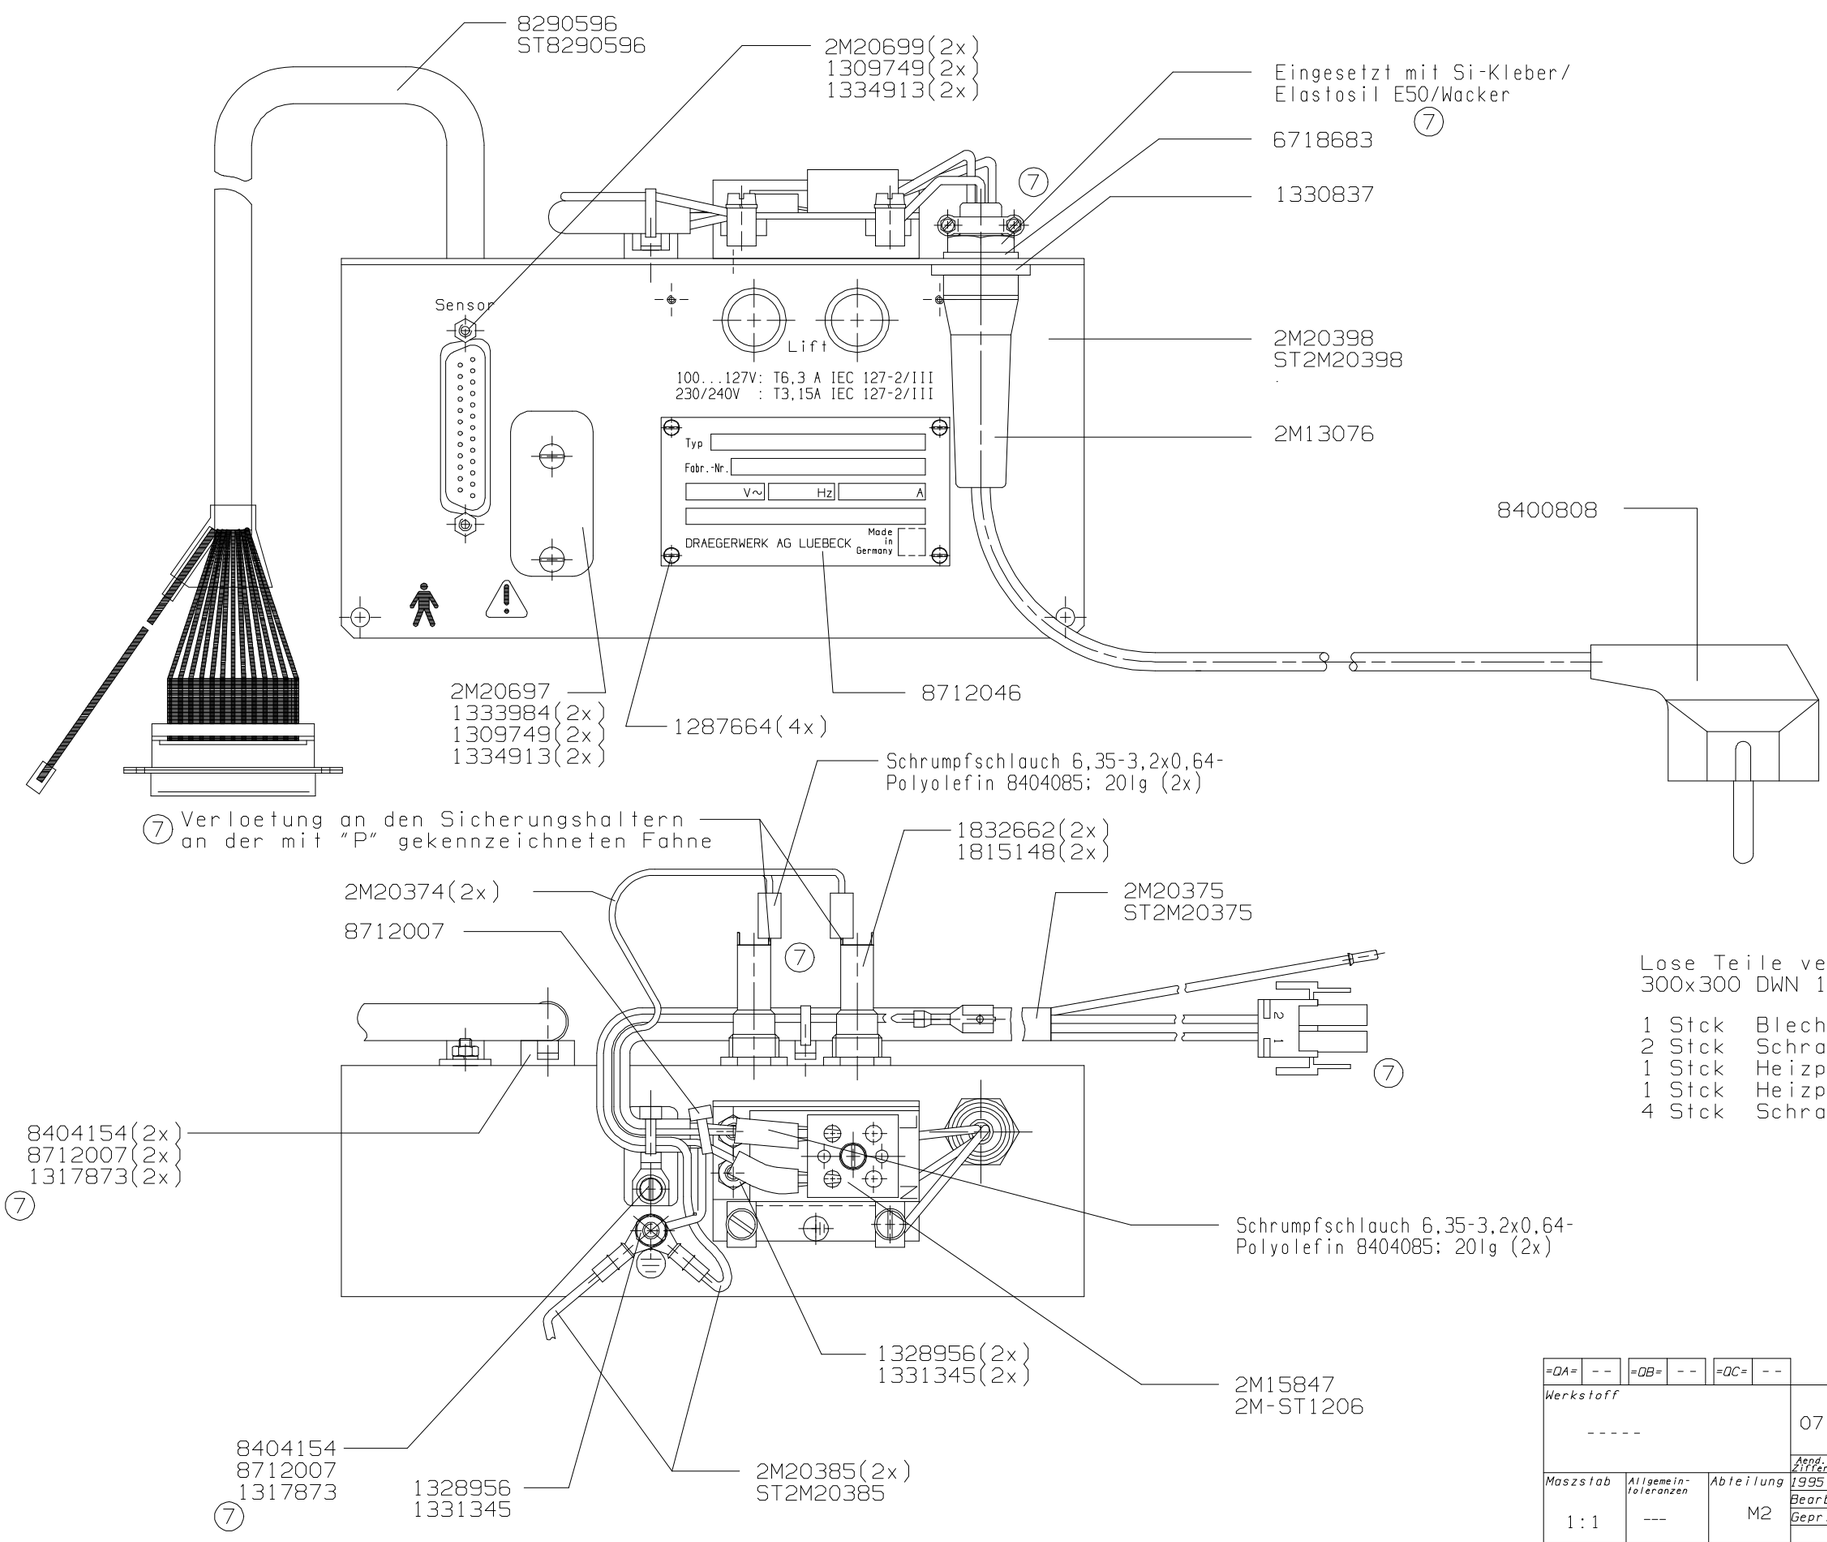

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind. 300x300 DWN 1210:

1 Stck	Blech	2M20461, ST2M20461
2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Heizpatrone	2M20327
1 Stck	Heizpatrone	2M20329
4 Stck	Schraube	1338072

ST2M20421

=OA= -- =OB= -- =OC= --

Werkstoff: -----

Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen
07	7x	Sach-Nr. entfallen und Darstellung der Fertigung angepaszt: Si-Kleber geaendert
		(41/95)

Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung	1995	Tag	Name
1:1	---	M2	Bearb	22.02.	Meyer/Meyer
			Gepr.	22.02.	Conrad
				--	--

Dräger
Drägerwerk Aktiengesellschaft

PROD | CADRA=8

Benennung: Netzanschlusz 8000 IC (230V)

Zeichnungs-Nr.: 2M20421

Ersatz fuer 2M20421-06

Ersetzt durch

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Usa, or the document / contents is forbidden,
without express authority. All rights reserved.
Copyright © Drägerwerk A.G. Luebeck

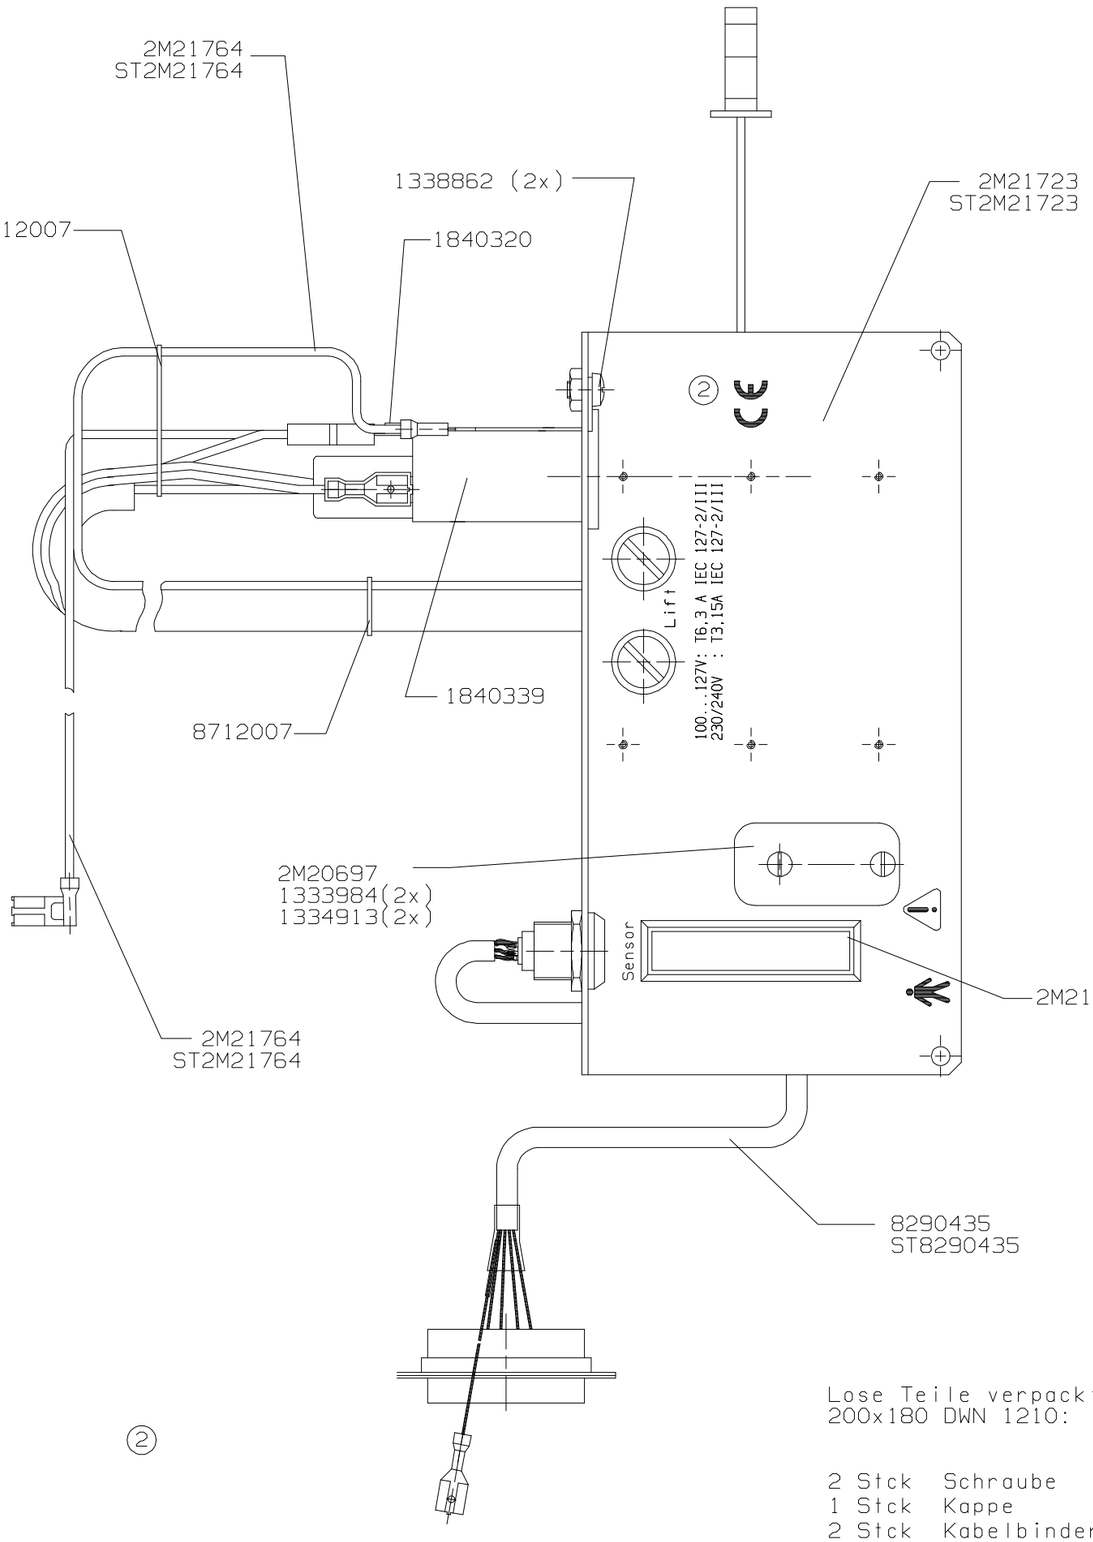

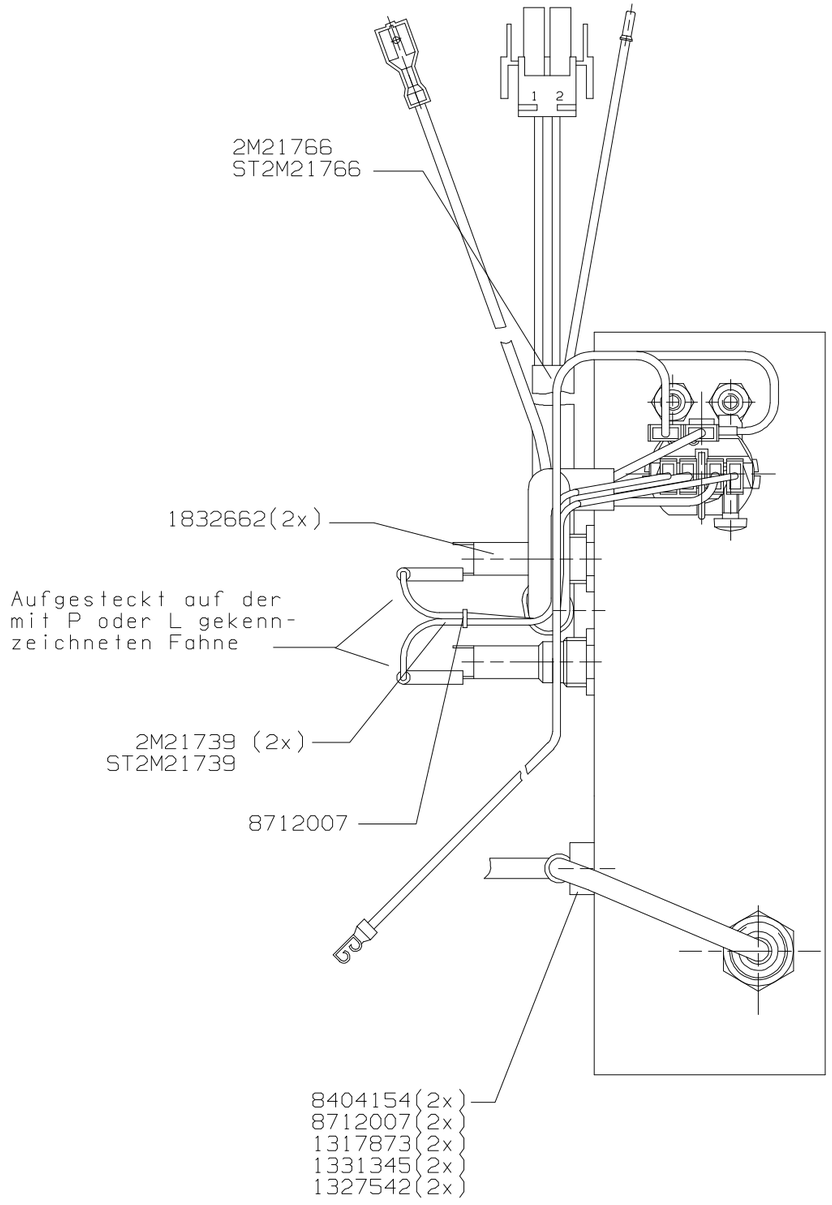

ST2M21755

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind. 200x180 DWN 1210:

2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Kappe	2M20356
2 Stck	Kabelbinder	8712007

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express author. right is reserved.
D-23611 Bad Oldesloe

=0A= --	=0B= --	=0C= --					
Werkstoff ---			02	2x	Text gestrichen, CE- Zeichen neu/01.		
					(25/96)		
			Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen		
Maszstab 1:1	Allgemeintoleranzen ---	Abteilung M2	1996	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger	
			Bearb	06.02.	NICKE		
			Gepr.	06.02.	Conrad		
				--	--		
		Benennung Netzanschlusz NC/SC variabel				Zeichnungs-Nr. 2M21755	
ARCHIV	CADRA=8					Ersatz fuer 2M21755 00	
						Ersetzt durch	

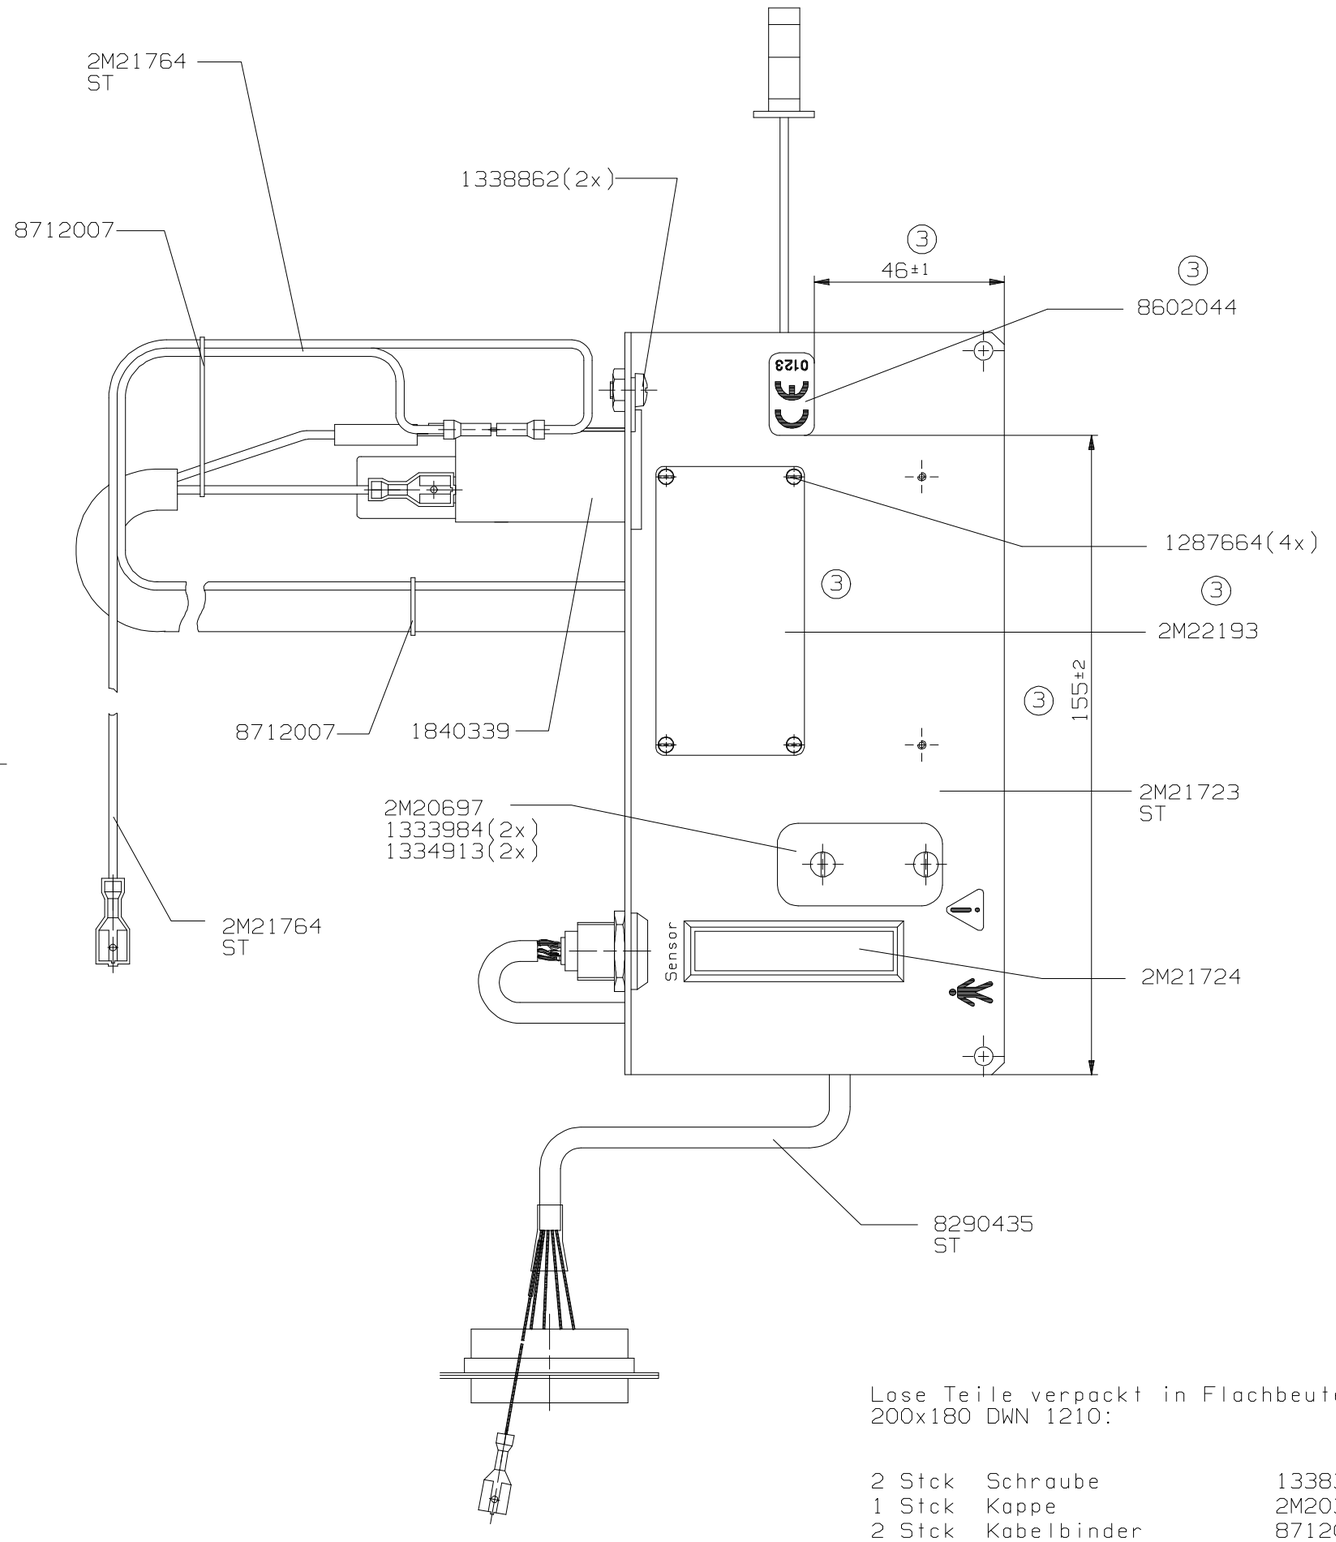

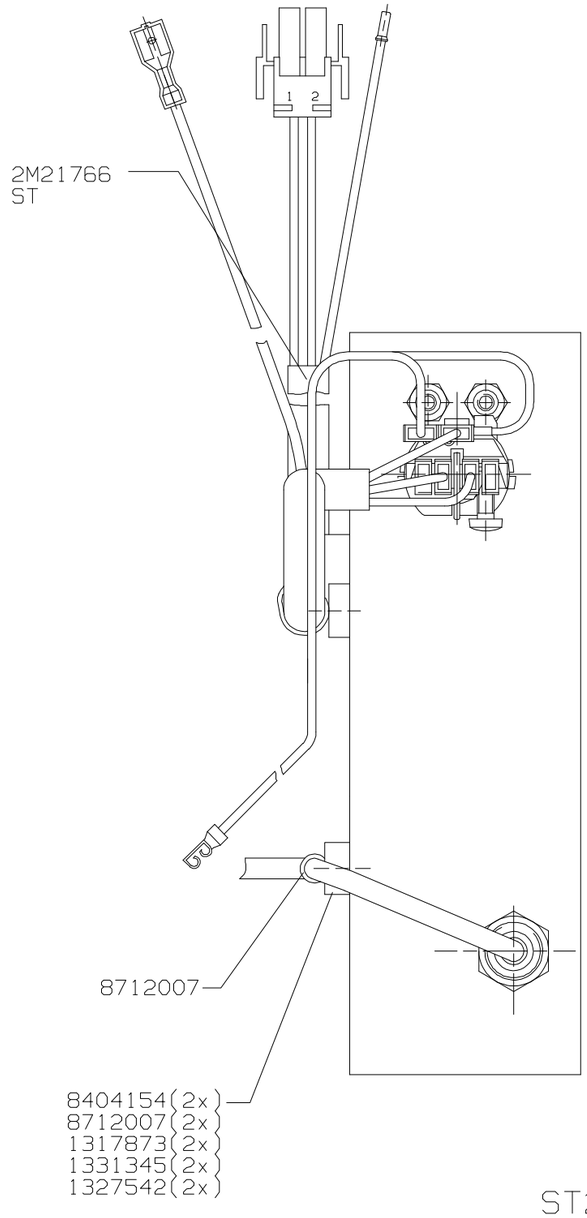

Lose Teile verpackt in Flachbeutel mind. 200x180 DWN 1210:

2 Stck	Schraube	1338382
1 Stck	Kappe	2M20356
2 Stck	Kabelbinder	8712007

ST2M21754

scale: 1:1	general tolerances: ---	material: ---	safety class: <s> 0, <m> 0
field reserved	revision text: Schild, Abdeckkappe und Masze nachgetragen; Darstellung geaendert (1998/CC/135)		
filing dept.: 2530	responsible dept.: 3401	author / approved / contract: date 27.04.1998 / 27.04.1994; name Stickel / Hartwig; n	
type: drawing	language: de; replacement for: 2M21754-02	title: Netzanschlusz NC/SC, fest; number: 2M21754	Dräger
creating system: CADRA	release status: PROD	revision index: 03	accures: 6x	page/of: 01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A2

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / content is forbidden.
without permission of Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck.